

試験結果報告書

総葉数 1 枚内の 1

平成 年 月 日作成


依頼者			
所在地			
試験項目	寸法測定		
品名・数量	対物マイクロメーター 1個		
製造者	---		
受付番号	19-6131		
使用測定器	測長器(三井精機)、レーザ干渉測長器(HP)、エッジセンサ(ニコン)		
試験年月日	平成 年 月 日	温度	20℃

試験の結果は次のとおりです。

目盛(mm)	誤差(μm)
0~0.1	+0.2
0.2	0.0
0.3	+0.2
0.4	0.0
0.5	+0.2
0.6	0.0
0.7	+0.2
0.8	0.0
0.9	+0.2
1.0	0.0

1. 試験の精度は±0.5 μm です。

備考：実際の値は目盛値に誤差を加えます。

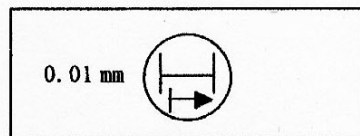

測定説明図

承認	担当